



MEDISEND®super/C

Pulsierendes Magnetfeld und Bioresonanz

Das **MEDISEND®super** und das **MEDISEND®super C** sind zwei der beliebtesten von Dr. W. Ludwig entwickelten **Magnetfeldgeräte** zum Einsatz in der Praxis.



Eines zum Verständnis vorweg:

Die Magnetfeldgeräte **MEDISEND®super** und **MEDISEND®super C** unterscheiden sich nur in einer einzigen Eigenschaft: Das **MEDISEND®super C** hat eine **Schnittstelle**, an die man einen **Computer mit dem AMScomsystem** anschließen kann, um **digitalisierte Mittel** zur Anwendung zu nutzen. Mehr Informationen zum AMScomsystem finden Sie auf der Rückseite dieses Prospektes. Abgesehen von dieser Schnittstelle handelt es sich um baugleiche Geräte mit **denselben Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten**. Eine nachträgliche Aufrüstung mit der Schnittstelle für ein **MEDISEND®super** ist **nicht** möglich.

Die **MEDISEND®super**-Geräte vereinen bewährte Methoden der Erfahrungsheilkunde:

- Pulsierendes Magnetfeld
- Bioresonanzverfahren

MEDISEND®super und **MEDISEND®super C**...

bauen auf den biophysikalischen Erkenntnissen von Dr. rer. nat. W. Ludwig, Institut für Bioinformativ Medizin, Weikersheim auf. Sie nutzen das **pulsierende Magnetfeld** als **Anwendungssignal** und zusätzlich als **Trägersignal für exogene und endogene Bioinformationen/Substrate**. Dr. Ludwig fand zusammen mit zahlreichen Anwendern spezifische Frequenzprogramme für eine breite Auswahl von Anwendungen, um gezielt die Selbstheilungskräfte des Organismus anzuregen.

verfügen über je **einen Frequenzgenerator** mit dem Sie eine Frequenzbandbreite von 0,1 - 1000 Hz einstellen können. Die eingestellte Frequenz lässt sich bei Bedarf zusätzlich modulieren.

nutzen die **MAGNETO-Schleife** als Applikator und übertragen hiermit das Magnetfeld zur Anwendung. Die Schleife ist unkompliziert in der Handhabung und handlicher als z.B. eine große Matte.

verhindern durch den **eingebauten Hochleistungsakku** Elektrosmog und dessen Übertragung. Dies ist entscheidend für das **störungsfreie Einschwingen** von exogenen und endogenen Bioinformationen und von großer Wichtigkeit insbesondere für elektrosensible Personen.

geben die Möglichkeit, einen **MEDICUP** und **Handelektroden** anzuschließen. Hiermit können Sie auf **analogem** Wege sowohl **exogene** (z.B. Homöopathika) als auch **endogene** (körpereigene) Informationen **auf das Magnetfeld übertragen** und zur Anwendung nutzen.

Das **MEDISEND®super C** beinhaltet eine **digitale Schnittstelle** für den Anschluss eines Laptops mit der Steuersoftware **AMScomsystem**. Hiermit können Sie **digitale Bioinformationen** zur Übertragung, Testung und Anwendung einsetzen sowie auf dem Kleingerät **METRONOM C** abspeichern.

pulsierendes Magnetfeld
für Anwendung und
Informationsübertragung →

Frequenzspektrum
0,1 - 1000 Hz →

handlicher Applikator →

eingebauter Akku →

analoge und digitale
Substratübertragung →

MEDISEND®super/C

Förderung der Regulationsfähigkeit

Anwendung →

Die Handhabung der **MEDISEND®super-Geräte** ist sehr einfach: Sie stellen mittels des Drehknopfes die **gewünschte Frequenz** ein, die Sie entweder mit einem **geeigneten Testverfahren** austesten oder aus der mitgelieferten **Liste der Erfahrungswerte** entnehmen. Dann starten Sie das Gerät. Die angeschlossene **MAGNETO-Schleife** gibt das pulsierende Magnetfeld in der gewählten Frequenz ab. Legen Sie die Schleife auf oder neben den Körper, um ihn in den **Wirkungskreis** des Magnetfeldes zu bringen (ca. **2 m** im Durchmesser).

Bio-
resonanz →

Die Geräte sind bestens geeignet, um sowohl **exogene** (z.B. Homöopathika) als auch **endogene** (körpereigene) **Bioinformationen** mit auf das pulsierende Magnetfeld zu übertragen und somit in die Anwendung einzubringen.

Die Stromversorgung wird durch einen **wiederaufladbaren Akku** gewährleistet. Ein Schalter zur Trennung vom Stromnetz sorgt dafür, dass während der Anwendung **kein zusätzlicher Elektromog** erzeugt und übertragen wird.

Eine Anwendung dauert in der Regel **15 Minuten** - es sind jedoch auch längere oder kürzere Einheiten möglich.

Sie können das pulsierende Magnetfeld als **alleinige Anwendung** nutzen oder aber auch andere **Verfahren damit kombinieren**. So lässt sich z.B. währenddessen eine Fußreflexzonenmassage durchführen oder Sie nutzen das Magnetfeld für die Verweildauer der Nadeln während einer Akupunktursitzung.

Vor und nach der Anwendung sollte möglichst viel mineralarmes Wasser getrunken werden, um den Körper in seiner **Regulationsfindung und Ausleitung** zu unterstützen.

Frequenzen →

Die **MEDISEND®super-Geräte** haben **je einen Frequenzgenerator**, mit dem sich die Frequenzen zwischen 0,1 und 1000 Hz einstellen lassen. Die abgegebenen **Oberwellen reichen bis in den MHz-Bereich** hinein. Somit generieren die Geräte sämtliche **RIFE- und CLARK-Frequenzen** bis 10 MHz.

Weiterhin haben Sie die Wahl zwischen **zwei Frequenzdurchläufen**: 1000 bis 1 Hz und 100 bis 1 Hz. Hierbei durchläuft das Gerät innerhalb von ca. acht Sekunden alle Frequenzen in dem gewählten Intervall. Ist der Frequenz-Zyklus durchlaufen, beginnt er wieder von vorn. Dem Körper wird hiermit eine große Bandbreite an Frequenzen angeboten, **um die Regulation anzuregen**. Die Frequenzdurchläufe werden häufig zur **Unterstützung von ausleitenden Verfahren** gewählt oder als **Einstieg in einen Anwendungszyklus**.

Auswahl der
Frequenzen →

Zur Auswahl der Frequenzen können Sie die mitgelieferte **Liste mit Erfahrungswerten** nutzen. Bei komplexen Fragestellungen ist es sinnvoll, wenn Sie die Wahl der Frequenzen durch ein **Testverfahren** unterstützen, wie z.B. Tensortestung, Kinesiologie, EAV oder RAC.

Die AMS bietet regelmäßig ein bis zwei Mal im Jahr einen **Tensorkurs** zum Erlernen dieser Testmethode an. Termine und mehr Information finden Sie auf unserer Webseite www.ams-ag.de im Menüpunkt **Seminare**.

Neben den unterschiedlichen einstellbaren Frequenzen (u.a. die Einstellung auf **7,8 Hz, den Hauptwert des Schumannfrequenzspektrums**) werden von den **MEDISEND®super-Geräten** immer zusätzlich auch die **Geomagnetfrequenzen** und die **Solarfrequenzen** abgegeben - **unabhängig davon**, welche spezifische Frequenz Sie zur Anwendung wählen.

Umwelt-
signale →

Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen sind unsere **Umweltsignale**. Wir nennen sie die „Biologischen Normale“. Die genaue Beschreibung für diese Signale finden Sie auf unserem doppelseitigen Informationsblatt **Magnetfeldtherapie - Bioresonanz - Bioinformatives Verfahren** oder auf unserer Webseite www.ams-ag.de im Menüpunkt **Grundlagen Magnetfeldtherapie**.

Übertragung von Bioinformationen - analog und digital

Zu den **MEDISEND®super-Geräten** gibt es **passendes Zubehör**, das zum Teil im Lieferumfang enthalten ist. Einige andere Zubehöreile können Sie **optional** dazu erwerben.

→ **MAGNETO-Schlaufe** zur Übertragung des pulsierenden Magnetfeldes (im Lieferumfang enthalten):

Um das pulsierende Magnetfeld für eine Anwendung nutzen zu können, muss ein Applikator - z.B. die **MAGNETO-Schlaufe** - angeschlossen sein. Durch sie wird das Magnetfeld abgegeben. Sie wird für die Anwendung **auf oder neben den Körper** gelegt.

Der **physiologische Wirkungskreis** des von der Schlaufe abgegebenen elektromagnetischen Feldes reicht bis zu 2 m im Durchmesser. Es ist **weder sicht- noch hörbar**. Sehr sensible Menschen spüren manchmal etwas - das muss aber nicht sein.

Ein pulsierendes Magnetfeld hat die Fähigkeit, **Informationen transportieren und übertragen** zu können. Dies ist vergleichbar mit den Funkwellen aus dem Fernsehen oder dem Radio: Hierbei erfolgt eine Übertragung von Bild und Ton durch eine modulierte Trägerwelle (z.B. UKW-Frequenzen). Im Rahmen der Bioresonanz nach Dr. Ludwig wird das pulsierende Magnetfeld zusätzlich als **Trägerwelle für Bioinformationen** genutzt. Man bezeichnet es als „Einschwingen“ von **exogenen** (körperfremden) oder **endogenen** (körpereigenen) Bioinformationen.

Um das Magnetfeld auch als **Transportschiene im Sinne der Bioresonanz** nutzen zu können, werden **MEDICUP** und **Handelektroden** an das Gerät angeschlossen.

→ **MEDICUP** für die exogene Informationsübertragung (optional erhältlich):

An die **MEDISEND®super-Geräte** lässt sich ein Becher - der **MEDICUP** - anschließen, um **exogene Informationen** mit dem pulsierenden Magnetfeld zu übertragen. Hierzu stellen Sie die Mittel (z.B. Homöopathika) am besten in einer Ampulle oder einem Glasröhrchen hinein. Sobald die Anwendung mit dem Gerät gestartet wird, fungiert das elektromagnetische Feld nicht nur als **Anwendungssignal**, sondern gleichzeitig auch als **Transportwelle** für jene Informationen, die sich im MEDICUP befinden. Die Übertragung der Informationen ist **unabhängig davon**, welche Frequenz Sie wählen: **Jede Frequenz ist Trägerwelle** und kann zum Einschwingen/Übertragen eingesetzt werden.

Wie auch schon bei der Auswahl der Frequenz ist es ebenso bei der Auswahl der zu übertragenden Substrate ratsam, die Mittel vorher durch ein **geeignetes Testverfahren** auszutesten.

→ **Handelektroden** für die endogene Informationsübertragung (optional erhältlich):

Mit Hilfe von angeschlossenen **Handelektroden** können Sie mit dem pulsierenden Magnetfeld auch **endogene (körpereigene) Informationen** übertragen. Über den **symmetrischen Hautkontakt** (rechte und linke Körperhälfte) werden die endogenen Bioinformationen durch die Handelektroden abgegriffen und in Form von „**Aufmerksamkeitssignalen**“ im Sinne der Bioresonanz an den Körper zurückgeführt. Die Handelektroden dienen dazu, die Informationen des kompletten Körper-Biofeldes **aufzunehmen**. Diese aufgenommenen Informationen werden auf das von der Schlaufe abgegebene Magnetfeld moduliert und mit diesem wieder **an den Körper zurück gegeben**.

Die Anwendung des pulsierenden Magnetfeldes in **Kombination mit endogenen und exogenen Informationen** fördert z.B. ganz besonders **Ausleitungsprozesse**.

Die MAGNETO-Schlaufe gibt das pulsierende Magnetfeld ab



Informationsübertragung

MEDICUP für exogene Information



Handelektroden für endogene Information



Abb. ähnlich

Digitale Übertragung mit dem AMScomsystem - Die optimale Ergänzung zum MEDISEND®super C



Mit dem **MEDISEND®super C** ist es möglich, neben analogen auch **digitalisierte Substrate zur exogenen Informationsübertragung** zu nutzen. Wir haben hierfür die Software **AMScomsystem** entwickelt und weit über 6.000 Präparate (Homöopathika, Bachblüten, Nosoden, Phytotherapeutika usw.) digitalisiert. Diese digitalisierten Mittel nennen wir **BIOWAVES**, die wir in unterschiedlichen Paketen zusammengestellt haben. Sie steuern Ihr **MEDISEND®super C** durch den **Computer** und übertragen während der Anwendung mit Hilfe des Magnetfeldes die gewählten BIOWAVES als exogene Bioinformationen.

Preis Laptop mit AMScomsystem (ohne BIOWAVES) inkl. MwSt.: 2.890,- €
Die BIOWAVE-Pakete sind separat erhältlich.

Bitte beachten Sie:

Das **MEDISEND®super** lässt sich nachträglich **nicht** mit einer Schnittstelle für den Computeranschluss nachrüsten. Wenn Sie sich die Möglichkeit zur Nutzung des Computers für die Zukunft offen lassen, ihn aber nicht sofort kaufen möchten, sollten Sie gleich in das **MEDISEND®super C** investieren.

Kombination mit Kleingeräten

Zwei unserer handlichen **Kleingeräte** lassen sich besonders gut mit dem **MEDISEND®super-Geräten** kombinieren:

CEPES-Laser®Vario:

Er wird mit seinem Kabel an das **MEDISEND®super/C** angeschlossen und zeitgleich mit der Magnetfeld-Anwendung genutzt. Der Rotlicht-Laser gibt ein pulsierendes Magnetfeld in jener Frequenz ab, die am **MEDISEND®super/C** eingestellt ist - und zusätzlich alle exo- und endogenen Bioinformationen, die durch MEDICUP und Handelektroden bereitgestellt werden.

Preis inkl. MwSt.: 599,- €



METRONOM C:

Dies ist eines unserer praktischen Kleingeräte. Es hat fünf Programme und verfügt über einen Speicherplatz, auf dem sich mit dem **MEDISEND®super C** in Kombination mit der **AMScomsystem-Software** ein BIOWAVE abspeichern lässt. Während der Anwendung des **METRONOM C**-Gerätes kann der darauf gespeicherte BIOWAVE zu jedem der fünf Programme hinzugeschaltet werden. Die Information des BIOWAVES wird auf das abgegebene Magnetfeld aufmoduliert und somit übertragen. Es ist ideal für Therapeuten als Leihgerät für Patienten.

Preis inkl. MwSt.: 589,- €



Gut zu wissen: Bei gleichzeitigem Kauf von Groß- und Kleingerät erhalten Sie auf das Kleingerät 10% Sonderrabatt.

Erfahren Sie mehr zum **AMScomsystem**, **CEPES-Laser®Vario** und zum **METRONOM C** in den jeweiligen Produktbroschüren oder unserem Gesamtkatalog. Eine komplette Auflistung aller digitalisierten BIOWAVES enthält unser **BIOWAVE-Katalog**. Rufen Sie uns an, um die entsprechenden Unterlagen anzufordern oder besuchen Sie unsere Webseite: **www.ams-ag.de / Login / Benutzername: ams2005, Passwort: ams2005**

MEDISEND®super/C

Technische Daten:

- Magnetfeldfrequenzen:** Bandbreite 0,1 - 1000 Hz, zwei Frequenzdurchläufe: 1000 - 1 Hz und 100 - 1 Hz
- Physiologische Reichweite:** bis zu 2 m im Durchmesser
- Batterie:** eingebauter Hochleistungsakku
- Gewicht:** 1,5 kg ohne Applikator
- Größe:** 26,5 x 19,0 x 10,6 cm
- Lieferumfang:** Steuergerät **MEDISEND®super** oder **MEDISEND®super C**, Applikator (MAGNETO-Schlaufe), Akku-Ladegerät, Gebrauchsanweisung
Nur **MEDISEND®super C**: Zwei Verbindungskabel für Laptop und METRONOM C
- Nicht im Lieferumfang enthalten:** MEDICUP, Handelektroden, METRONOM C, CEPES-Laser®Vario, Laptop und Steuersoftware AMScomsystem. Sie sind als Zubehör **optional** erhältlich.

Garantie: 2 Jahre

Preis:	MEDISEND®super C mit PC-Schnittstelle	MEDISEND®super ohne PC-Schnittstelle
Preis netto:	4.470,59 €	3.882,35 €
Preis inkl. MwSt.:	5.320,- €	4.620,- €
Versandkosten:	15,- €	15,- €

5.320,- € 4.620,- €

Bestell-Nr. 204

Bestell-Nr. 201

Zubehör (optional):

- MEDICUP:** zweipoliger Becher (Höhe 7 cm, Durchmesser 5,5 cm), Anschlusskabel (18 cm)
Preis inkl. MwSt.: 350,- €
- zwei Handelektroden:** aus V2A Stahl (Länge 10 cm, Durchmesser 2 cm), Anschlusskabel (2 m)
Preis inkl. MwSt.: 220,- €

Zahlungsmöglichkeiten:

Bankeinzug/Vorkasse (3% Skonto), Kreditkarte (Master/Visa), PayPal

Bestellen Sie ...

telefonisch 0 79 34 / 99 34 89 - 0
oder in unserem Onlineshop
www.ams-ag.de

AMS GmbH
Advanced Medical Systems

Hauptstraße 26 • D-97990 Weikersheim • Tel.: 0 79 34 / 99 34 89-0
info@ams-ag.de • www.ams-ag.de


Danke

Magnetfeldtherapie • Bioresonanz • Bioinformative Verfahren

Physik

Der Kosmos, alle lebenden Organismen, Menschen, Tiere und Pflanzen bestehen nur aus einem milliardsten Teil fester Materie, den Atomkernen und den sie umgebenden Elektronen. Dazwischen befindet sich ein großer, „leer“ erscheinender Raum, der jedoch gefüllt ist mit elektromagnetischen Wellen. Diese elektromagnetischen Felder stehen untereinander und mit der Außenwelt kommunizierend in Kontakt.

Der Physiker Dr. W. Ludwig (1927 – 2004) strebte danach, mit einem Gerät elektromagnetische Wellen zu erzeugen, die vom Körper verstanden werden. Sie sollten **der ungestörten Natur nachempfunden** sein. Nur so können sie eine Reaktion des Körpers hervorrufen. Deshalb untersuchte er die uns umgebenden physiologischen Umweltsignale. Für seine Doktorarbeit beschäftigte er sich mit dem Einfluss elektromagnetischer Felder auf das Nervensystem.



Was versteht man darunter und was ist das Besondere an den AMS-Geräten von Dr. Ludwig®?

Lesen Sie nachfolgend über die Eigenschaften von pulsierenden Magnetfeldern und wie sie genutzt werden können:

- Kleiner Ausflug in die **Physik**
- Physiologische **Umweltsignale**: Schumann-, Geomagnet und Solarfrequenzen – Signale, die uns naturgemäß aktuell umgeben
- **Qualitätsmerkmale** physiologisch wirksamer Magnetfeldgeräte
- **Anwendungsmöglichkeiten** der Magnetfeldtherapie

Auf eine wissenschaftlich eingehende Betrachtung der Wirkungsweise von Magnetfeldern wird in diesem Rahmen bewusst verzichtet – gerne können Sie uns kontaktieren, um sich eingehender zu informieren.

Umweltsignale

Bei intakter Umwelt sind wir verschiedenen Frequenzen und Frequenzspektren ausgesetzt, an die unser Organismus gewöhnt ist:




Schumannfrequenzen

1952 entdeckt von dem Physiker Winfried Otto Schumann.

Eine Frequenz, die permanent zwischen Erdoberfläche und Ionosphäre durch Entladungen der Atmosphäre (Gewitter) aufrecht erhalten wird. Dadurch entsteht eine sogenannte transversal magnetische Welle mit einer Grundfrequenz von **7,8 Hz** – die **Schumannfrequenz**. Ihre Oberwellen reichen bis in den Megahertzbereich.

Ein Teil des Gehirns aller Säugetiere, der Hippocampus, schwingt ebenfalls mit 7,8 Hz. Der Hippocampus ist u.a. wichtig für Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit.

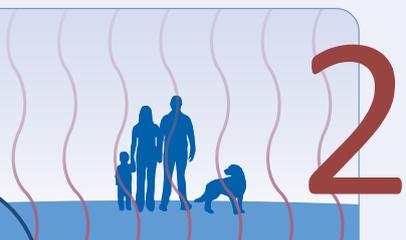

Geomagnetfrequenzen

Hierbei handelt es sich um die Schwingungen von **64 Spurenelementen** wie Eisen, Natrium, Calcium usw., die in unserer Erdkruste enthalten sind. Jedes dieser Spurenelemente hat ein charakteristisches Schwingungsmuster. Das natürliche Erdmagnetfeld nimmt diese Schwingungsmuster auf – dies wird als „Modulation“ bezeichnet. Somit sind wir in natürlicher Umgebung ständig mit den Informationen der Spurenelemente in Berührung.

Laut Messungen von Geologen und Medizinern sind in der Erdkruste die gleichen Spurenelemente enthalten wie in den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen – und zwar nahezu im gleichen Verhältnis untereinander.



Solarfrequenzen

Die Sonne ist eine weitere natürliche Quelle wichtiger Signale für uns. Sie sendet verschiedenste Frequenzspektren, von denen die meisten nicht bis zur Erdoberfläche gelangen.

Es gibt in der Atmosphäre jedoch zwei „Fenster“, durch die bestimmte Frequenzen der Sonne zu uns dringen: **Licht im sichtbaren Bereich und Frequenzen im UKW-Bereich**

Dabei lässt sich feststellen, dass es für jede sichtbare Frequenz eine **korrespondierende Frequenz im UKW-Bereich** gibt. Dies sind die Solarfrequenzen.

Fragen Sie uns!

AMS GmbH
Advanced Medical Systems
Hauptstraße 26 • D-97990 Weikersheim
Tel. +49 (0)79 34 / 99 34 89-0
info@ams-ag.de • www.ams-ag.de



Die Jahrtausende alte klassische chinesische Medizin wusste bereits: Der Mensch braucht mindestens zwei Umweltsignale, ein **Yang-Signal von oben (Schumann- und Solarfrequenzen)** und ein **Yin-Signal von unten (Geomagnetfrequenzen)**.

Um diesen **Yin-Yang-Ausgleich** herzustellen, generiert jedes der von Dr. Ludwig® entwickelten Geräte sowohl die Schumannfrequenzen als auch die Geomagnetfrequenzen. Zusätzlich erzeugen alle Großgeräte sowie die Kleingeräte **MEDICUR®**, **MEDICUR®color**, **METRONOM solar** und **METRONOM C** auch die Solarfrequenzen.

noch ein bisschen weiter lesen ☺

Umweltsignale

Qualitätsmerkmale

Um eine physiologische Wirksamkeit der erzeugten Wellen zu erreichen, müssen diese bestimmte Eigenschaften aufweisen. Dabei sind **Magnetfeldstärke und Impulsform** des Signals von besonderer Wichtigkeit.

Der amerikanische Physiker R. Adey stellte fest, dass eine positive physiologische Wirkung von Magnetfeldern auch schon bei schwacher Feldstärke nachweisbar ist. Es muss lediglich die physiologische Ansprechschwelle erreicht werden – eine größere Intensität kann unter Umständen sogar kontraproduktiv wirken. Deshalb liegt die **Magnetfeldstärke** der von Dr. Ludwig® entwickelten Geräte bei geringen 0,2 – 20 µTesla.

Um eine **Impulsform** zu nutzen, die dem Körper bekannt ist, orientierte sich Dr. Ludwig® bei der Entwicklung seiner Geräte an der Weiterleitungsform der Nervenimpulse. Diese ist gekennzeichnet durch einen schnellen Anstieg und ein darauf folgendes langsames Abklingen des Impulses.

nur noch ein Kasten

Anwendungsmöglichkeiten

Bereits im Altertum wurden Krankheiten mit sogenanntem „Magnetit“ (natürliches Magnetgestein) erfolgreich behandelt. Das Prinzip ist einfach: Magnetfelder können die **Regulationsfähigkeit** verbessern und so zur Aktivierung der **Selbstheilungskräfte** beitragen.

Eine der wichtigsten Frequenzen – wenn nicht gar die wichtigste von allen – ist der Hauptwert der Schumannfrequenzen von 7,8 Hz. Sie ist neutral, ausgleichend und unterstützt die Konzentration. Wir nennen sie die „Wohlfühlfrequenz“. Eine randomisierte placebokontrollierte Doppelblindstudie wurde mit dem von uns vertriebenen Gerät MEDICUR® durchgeführt. Dabei wurde die Wirksamkeit von 7,8 Hz bei Kniearthrose nach schulmedizinischen Kriterien belegt. Bei Interesse können Sie die Studie bei uns anfordern.

Generell kann jede Frequenz für eine Anwendung geeignet sein. Einige Frequenzen haben sich für bestimmte Situationen bewährt. So gibt es beispielsweise einerseits anregende, tonisierende Frequenzen und andererseits solche, die eher zur Entspannung eingesetzt werden.

Die **Kleingeräte** von Dr. Ludwig® haben unterschiedliche **voreingestellte Programme/Frequenzen**, aus denen Sie wählen können. Mit den **Großgeräten (MEDISEND®super / MEDISEND®super C / MEDISEND®super III)** können Sie jede Frequenz zwischen **0,1 bis 1000 Hz** einstellen. Spezifische Information hierzu erhalten Sie in den jeweiligen Produktprospekten.

Eine Eigenschaft elektromagnetischer Wellen ist ihre Fähigkeit, Informationen aufnehmen und transportieren zu können. So kann die elektromagnetische Welle unserer Geräte als reines **Anwendungssignal** mit entsprechender Frequenz und zusätzlich auch als **Trägerwelle** genutzt werden. Sie kann sowohl exogene als auch endogene Informationen transportieren.

Die Kleingeräte verfügen zu diesem Zweck über einen **Ampullenhalter**. Großgeräte bieten die Möglichkeit, einen Becher (**MEDICUP**) für die Informationsübertragung/Substrateinschwingung anzuschließen.

geschafft!