



**Conexión MEDISEND super con MEDICUP, electrodos de mano y CEPES-Laser Vario:**

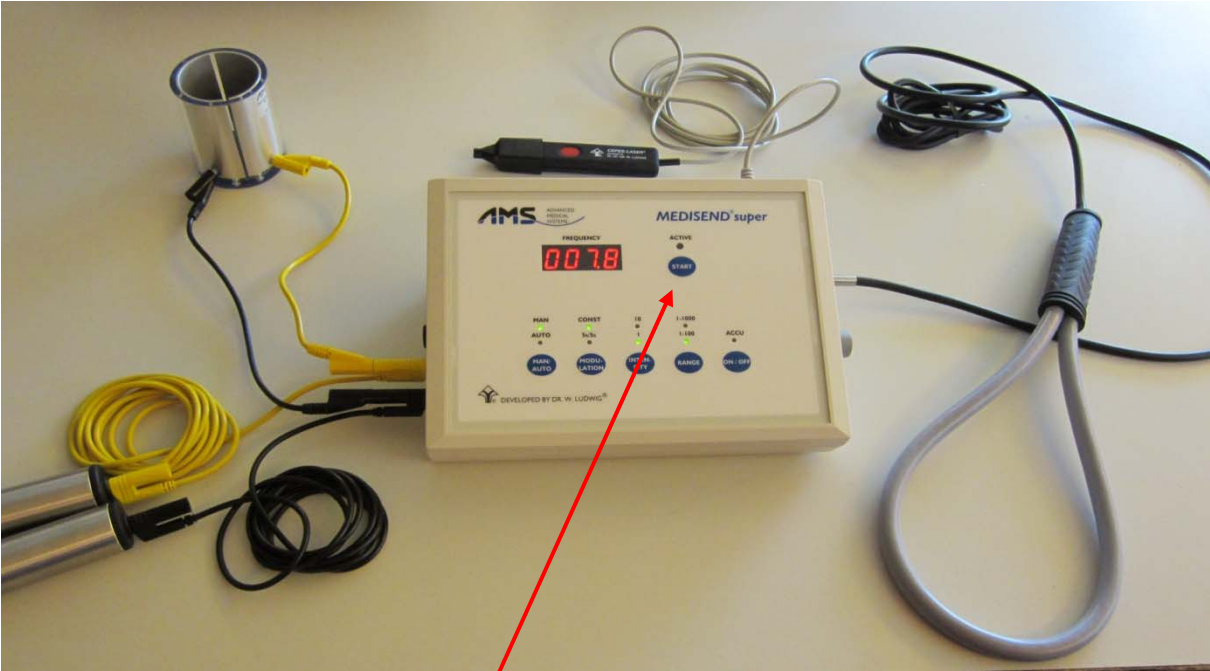



Para empezar el tratamiento, pulse "START" – el diodo brilla cuando el equipo está prendido.

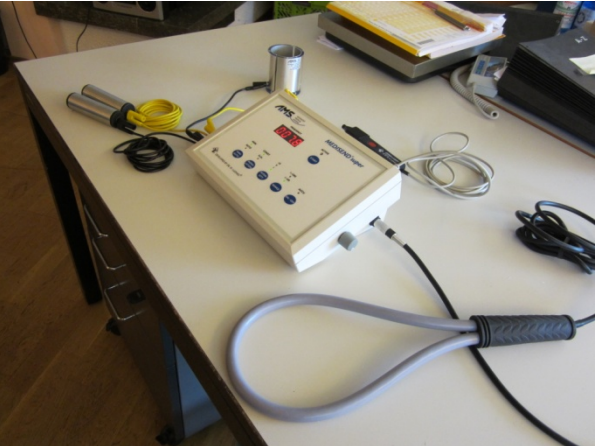

## Conexión con WAVE TRANSFER entre MEDICUP y MEDISEND super:


Si usa el WAVE TRANSFER así con el MEDISEND super para amplificar la señal, por favor usa:

Posición 1 o 2 y la posición “CON” (para que no se apague el WAVE TRANSFER): Pulse 2 veces a “START”.

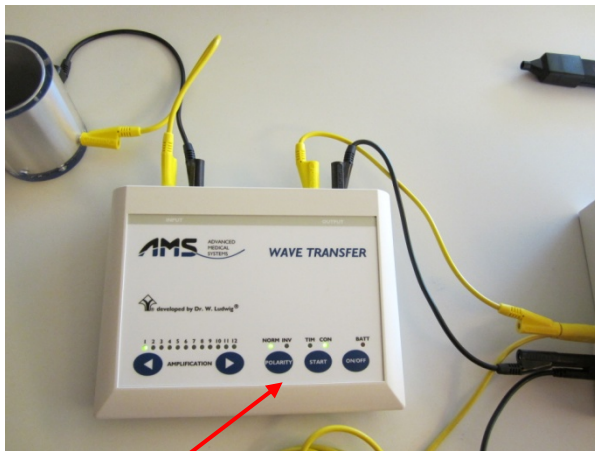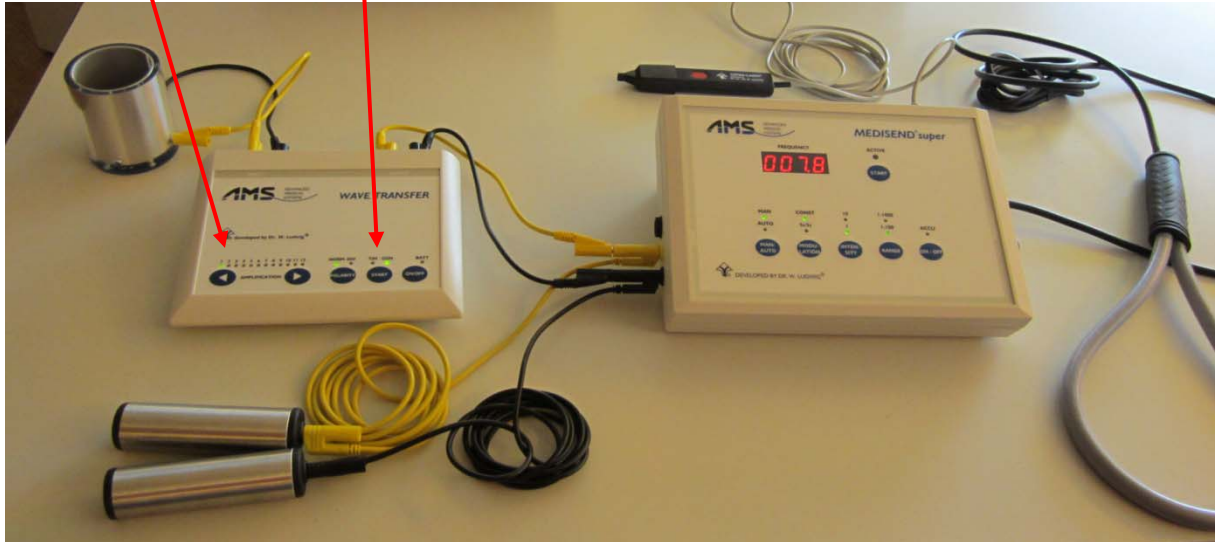

“NORM” hace el señal en la forma original, “INV” hace el señal invertido.

**Conexión del WAVE TRANSFER y los dos MEDICUPs para copiar remedios:**

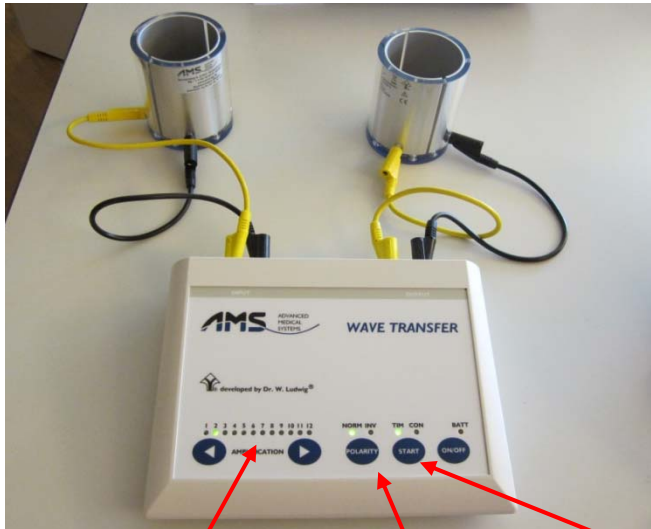

El remedio original se pone al Medicup izquierdo.

Al Medicup derecho se pone por ejemplo una ampolla con una solución, por ejemplo NaCl solución fisiológica.


Para la amplificación usa 1-3 si no tiene la oportunidad de ensayar cual amplificación es la mejor. Si quiere amplificar más, es mejor ensayarlo antes.

Puede copiar en original o invertido.

Con "TIM" el equipo apaga automáticamente despues de 15 segundos.  
With "CON" no se apaga.

**Comprobar la señal electromagnético del lazo y del CEPES-Laser:**

Encender la radio, no hay que regular algo mas.

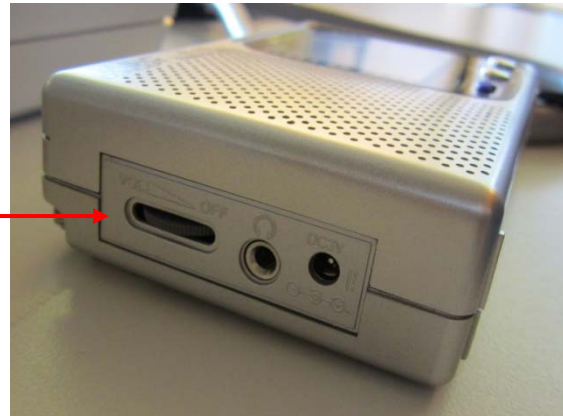

Encender el MEDISEND super y colocar la radio con la antena cerca al lado del lazo / del CEPES-Laser.

Se puede oír un ruido, algo como un crujido o silbido. La velocidad del ruido cambia dependiente de la frecuencia ajustada.